

CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA

MEIO DE CULTURA AGAR MACCONKEY

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
604.0	10443010014	Pacote com 10 placas	Lote: 080 Fab: 04/10/11 Val: 04/04/12	06/10/11	RNA Laboratórios LTDA CQ

TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento de Colônias rosadas com halo de precipitação da bile	Satisfatório
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores sem halo de precipitação da bile	Satisfatório
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Ausência crescimento	Satisfatório
pH	7,3 +/- 0,2	7,3
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Coloração	Vermelho	Vermelho
Outras características	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

TESTE DE ESTERILIDADE

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2°C-8°C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2°C - 8°C	SC / N
Análise de contaminação visual	24 horas	37°C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

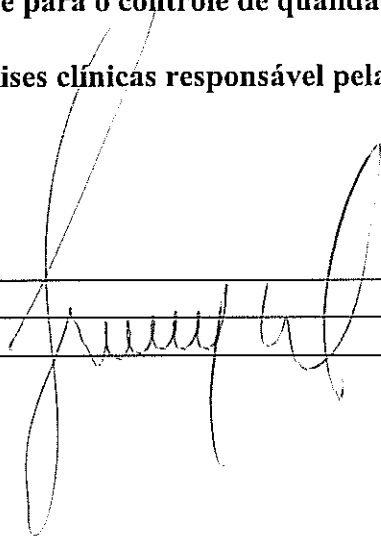
TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÉM

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 -8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A=anormal

OBS:

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	