

CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA

Meio de Cultura TAYER MARTIN+CHOCOLATE

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
1.462.5	10443010014	Pacote com 10 Biplacas	Lote: 014 Fab: 13/02/12 Val: 13/08/12	14/02/12	RNA Laboratórios LTDA CQ

TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Agar Choc. <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento	Satisfatório
Tayer Martin: <i>Neisseria Gonorrhoeae</i> ATCC 43069	Crescimento	Satisfatório
pH	Agar choc:7.3 Tayer Martin: 7.2	Agar choc:7.3 Tayer Martin: 7.2
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Coloração	Agar choc:Castanho escuro Tayer Martin:Chocolate	Agar choc:Castanho escuro Tayer Martin:Chocolate

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

TESTE DE ESTERILIDADE

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2°C à 8°C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2°C à 8°C	SC/N
Análise de contaminação visual	24 horas	37°C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

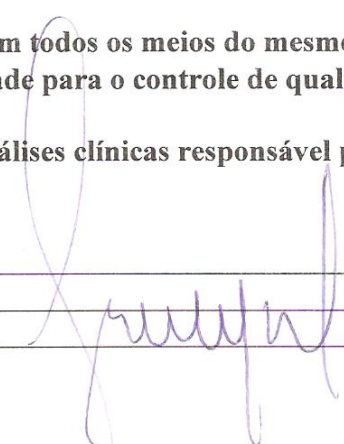
TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÊM

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 - 8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Características físicas	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão: <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	6 meses	NA	NA	NA
Semeadura direta com cepa padrão: <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 43069.	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anorma

OBS:

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF -PR 20336	