

**CERTIFICADO DE QUALIDADE RNA MEIOS DE CULTURA**

**MEIO DE CULTURA TODD HEWITT**

Cód. produto	Registro MS	Apresentação	Produção	Data do teste	Testado por
619.4	10443010014	Caixa com 10 tubos 13x100mm	Lote: 006 Fab: 15/09/11 Val: 15/03/12	16/09/11	RNA Laboratórios LTDA CQ

**TESTES DE FUNCIONABILIDADE E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Aspecto	Homogêneo	Homogêneo
Ph	7,8+- 0,2	7,8
COLORAÇÃO	Amarelo claro	Amarelo claro
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento	Satisfatório
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC10015	Crescimento	Satisfatório

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

**TESTE DE ESTERILIDADE**

METODOLOGIA	PERÍODO	TESTES	RESULTADOS
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	6 meses	2 a 8° C	NA
Análise de contaminação visual/Carac.físicas	10 dias	2 a 8° C	SC/N
Análise de contaminação visual	24horas	37° C	SC

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

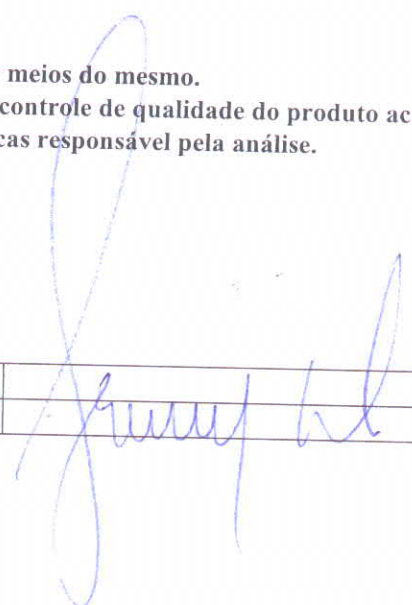
**TESTE DE ESTABILIDADE E FUNCIONABILIDADE DO RETÉM**

METODOLOGIA	PERÍODO	18 - 25°C	2 -8°C	> 36°C
Contaminação	6 meses	NA	NA	NA
Alteração de cor	6 meses	NA	NA	NA
Retração	6 meses	NA	NA	NA
Desidratação	6 meses	NA	NA	NA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	6 meses	NA	NA	NA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC10015	6 meses	NA	NA	NA

CD= crescimento desejado SC= sem crescimento N= normal NA= não se aplica A= anormal

**OBS:**

- Cada cepa padrão é semeada em uma unidade do produto em todos os meios do mesmo.
- Qualquer quantidade de colônias presentes indica positividade para o controle de qualidade do produto acabado.
- Responsável técnico do LCQ é a/o RT do Laboratório de análises clínicas responsável pela análise.
- LCQ: local onde são processadas as análises de CQ.

LCQ- analista	Greicy K. C. Echer CRF-PR 20336	
Responsável técnico	Greicy K. C. Echer CRF-PR 20336	